

ГОСТ 8682-93  
(ИСО 383-76)

Группа П66

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Посуда лабораторная стеклянная

ШЛИФЫ КОНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ

Laboratory glassware. Interchangeable conical ground V-joints

МКС 71.040.20  
ОКП 43 2500

Дата введения 1995-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России  
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по  
стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и  
сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 8682-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.

4 ВЗАМЕН [ГОСТ 8682-70](#)

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

0 Введение

Настоящий стандарт распространяется на конические стеклянные шлифы и обеспечивает взаимозаменяемость между ними независимо от места их изготовления.

Для достижения взаимозаменяемости необходимо, чтобы каждое из следующих требований было выполнено, включая соответствующие допуски:

а) конусность;

- b) наибольший диаметр шлифа;
- c) длина пришлифованного участка;
- d) чистота обработки поверхности.

Номинальные размеры, указанные ниже, выбраны из рядов соединений, широко используемых во многих странах; ряд наибольших диаметров шлифов представляет собой наиболее приемлемое приближение к  $R_{40/3}$  рядам номеров (5, 7, . . . , 100), установленных [ГОСТ 8032](#).

С практической точки зрения, в связи с трудностью измерения отшлифованных участков обработанных соединений, желательно применять систему калибров для проверки основных размеров.

Определение этих размеров в соответствии с разделом 6 является существенной частью настоящего стандарта, но система калибров, приведенная в приложении А, признанная на практике вполне удовлетворительной, не является единственной для применения в этом случае.

Испытание на герметичность, приведенное в приложении В, обычно применяют при испытании шлифов, его включение в настоящий стандарт не исключает применения других испытаний, которые могут быть более приемлемыми для особых целей.

Особое внимание уделяют методу пневматической калибровки.

## 1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт определяет основные геометрические требования к взаимозаменяемости в отношении четырех рядов конических стеклянных шлифов лабораторного применения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения](#)

[ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел](#)

## 3 Конусность

Конус шлифов должен быть таким, чтобы приращение диаметра соответствовало десяти приращениям осевой длины с допуском  $\pm 0,006$  на приращение диаметра, т.е. конус  $(1,00 \pm 0,006)/10$ .

Примечание - Современное производство в основном использует более жесткие допуски, чем указанные выше, но из-за отсутствия экспериментальных данных невозможно уменьшить установленную величину.

## 4 Наибольший диаметр шлифа

Наибольший диаметр шлифа выбирают из ряда: 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 14,5; 18,8; 21,5; 24,0; 29,2; 34,5; 40,0; 45,0; 50,0; 60,0; 71,0; 85,0; 100,0 мм.

## 5 Длина пришлифованного участка

Длину пришлифованного участка ( $l$ ) в миллиметрах рассчитывают по формуле

$$l = K\sqrt{d},$$

где  $K$  - константа (постоянная величина);

$d$  - наибольший диаметр шлифа, мм.

Вычисленную длину округляют до целого числа.

Четыре ряда шлифов, внесенных в таблицу 1, получены при использовании значений 2, 4, 6, 8 константы  $K$ .

Ряд  $K_6$  является предпочтительным.

Таблица 1 - Ряды шлифов

В миллиметрах

Наибольший диаметр шлифа	Длина пришлифованной зоны $l$ для рядов			
	$K_2$	$K_4$	$K_6$	$K_8$
5,0	-	9	13	18
7,0	-	11	16	22
10,0	-	13	19	25
12,5	-	14	21	28
14,5	8*	15	23	30
18,8	9	17	26	35
21,5	-	19	28	37
24,0	10	20	29	39
29,2	11	22	32	43
34,5	12	23	35	47
40,0	13	-	38	-
45,0	13	-	40	-

50,0	14	-	42	-
60,0	15*	-	46	-
71,0	-	-	51	-
85,0	18*	-	55	-
100,0	-	-	60	-

\* Размеры для шлифов, используемых для потребностей народного хозяйства.

## 6 Допуски на диаметр и длину

Диаметр и длина пришлифованной зоны должны быть такими, чтобы при наложении ее на плоскость размерной формы, показанной на рисунке 1, верхние и нижние границы пришлифованной поверхности совпадали с участками высоты  $h_1$  и  $h_2$  соответственно; значения  $d$ ,  $l$ ,  $h_1$  и  $h_2$  для каждого отдельного соединения берут из таблицы 2. В особых случаях пришлифованная поверхность может превышать эти значения при условии, что длина  $l$  всегда входит в эту пришлифованную часть.

### Рисунок 1.




Рисунок 1

Таблица 2 - Размеры и допуски (см. раздел 6 и рисунок 1)

Номи- нальный диаметр шлифа	$d$	Ряд $K_2$			Ряд $K_4$			Ряд $K_6$			Ряд $K_8$		
		$l^*$	$h_1^{**}$	$h_2^{**}$	$l^*$	$h_1^{**}$	$h_2^{**}$	$l^*$	$h_1^{**}$	$h_2^{**}$	$l^*$	$h_1^{**}$	$h_2^{**}$
5,0	5,1±0,008	-	-	-	8	2	2	12	2	2	17	2,5	2,0
7,5	7,6±0,008	-	-	-	10	2	2	15	2	2	21	2,5	2,0
10,0	10,1±0,008	-	-	-	12	2	2	18	2	2	24	2,5	2,0
12,5	12,6±0,010	-	-	-	13	2	2	20	2	2	27	2,5	2,0
14,5	14,6±0,010	7***	2,0***	2,0***	14	2	2	22	2	2	29	2,5	2,0
18,8	18,9±0,015	8	2,5	2,0	16	2	2	25	2	2	34	2,5	2,0
21,5	21,6±0,015	-	-	-	18	2	2	27	2	2	36	2,5	2,0
24,0	24,1±0,015	9	2,5	2,0	19	2	2	28	2	2	38	2,5	2,0
29,2	29,3±0,015	10	2,5	2,0	21	2	2	31	2	2	40	2,5	3,5
34,5	34,6±0,015	11	2,5	2,0	22	2	2	34	2	2	43	2,5	3,5
40,0	40,1±0,015	11	2,5	2,5	-	-	-	37	2	2	-	-	-
45,0	45,1±0,015	11	2,5	2,5	-	-	-	39	2	2	-	-	-

50,0	50,1±0,015	12	2,5	2,5	-	-	-	41	2	3	-	-	-
60,0	60,1±0,015	12***	2,5***	2,5***	-	-	-	45	2	3	-	-	-
71,0	71,1±0,020	-	-	-	-	-	-	50	2	3	-	-	-
85,0	85,1±0,020	13***	2,5***	2,5***	-	-	-	54	2	3	-	-	-
100,0	100,0±0,020	-	-	-	-	-	-	59	2	3	-	-	-

\* Допуск на  $l$  - в пределах  $\pm 0,015$  мм.

\*\* Допуск на  $h_1$  и  $h_2$  - в пределах  $\pm 0,010$  мм.

\*\*\* Размеры для калибров, используемых для потребностей народного хозяйства.

Система калибров для определения соответствия шлифов данным пределам приведена в приложении А.

## 7 Окончательная обработка поверхности

Параметр шероховатости  $R_a$  по [ГОСТ 2789](#) шлифованной поверхности не должен превышать 1 мкм и предпочтительно должен быть менее 0,5 мкм.

## 8 Обозначение



Для удобства при ссылках на шлифы, отвечающие требованиям настоящего стандарта на герметичность, рекомендуется пользоваться обозначением, состоящим из следующих размеров, выраженных в миллиметрах:

наибольший диаметр шлифа: 7,5; 12,5; 14,5; 18,8; 21,5; 29,2; 34,5; округляют до 7; 12; 14; 19; 21; 29; 34 соответственно, и

значение пришлифованного участка отделяют наклонной или горизонтальной чертой.

Пример: 19/26 или  $\frac{19}{26}$ .

Пример условного обозначения шлифа конического (КШ) диаметром 18,8 мм и высотой 9 мм для потребностей народного хозяйства:

*Шлиф КШ 19/9* ГОСТ 8682-93

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). Система калибров для диаметра и длины конических шлифов

### ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

Предлагаемые калибры изготовляют из закаленной стали или другого соответствующего материала. Калибрами для муфт являются конические пробки со ступенькой на каждом конце, а калибрами для кернов служат конические кольца со ступенькой на каждом конце (см. рисунки 2 и 3).

### Рисунок 2. Калибры для муфт

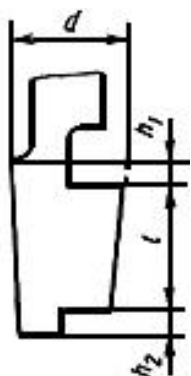


Рисунок 2

### Рисунок 3. Калибры для кернов




Рисунок 3

Конический полуугол каждого калибра равен  $2^{\circ}51'45'' \pm 15''$  (синус соответствующего угла равен  $0,04994 \pm 0,00007$ ).

Для каждого размера керна или муфты требуется отдельный калибр. Размеры калибров даны в таблице 2 настоящего стандарта. Когда муфта или керн подогнан под соответствующий калибр, они должны находиться в таком положении, чтобы верхние и нижние концы пришлифованного участка полностью лежали в пределах ступенек с высотой  $h_1$  и  $h_2$  соответственно.

В особых случаях пришлифованная поверхность может превышать внешний предел ступеньки на меньшем конце при условии, что она тоже доходит до внутреннего предела ступеньки на большом конце.


## **ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное). Испытание на герметичность конических шлифов**

### **ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)**

Испытание на герметичность проводят на сухих шлифах, наблюдая за скоростью повышения давления в предварительно разреженной системе, связанной с атмосферой через дающее утечку соединение.

Принципиальная схема установки общей емкостью системы приблизительно  $1,5 \text{ дм}^3$  показана на рисунке 4.

### **Рисунок 4. Установка для испытания конических шлифов на герметичность**

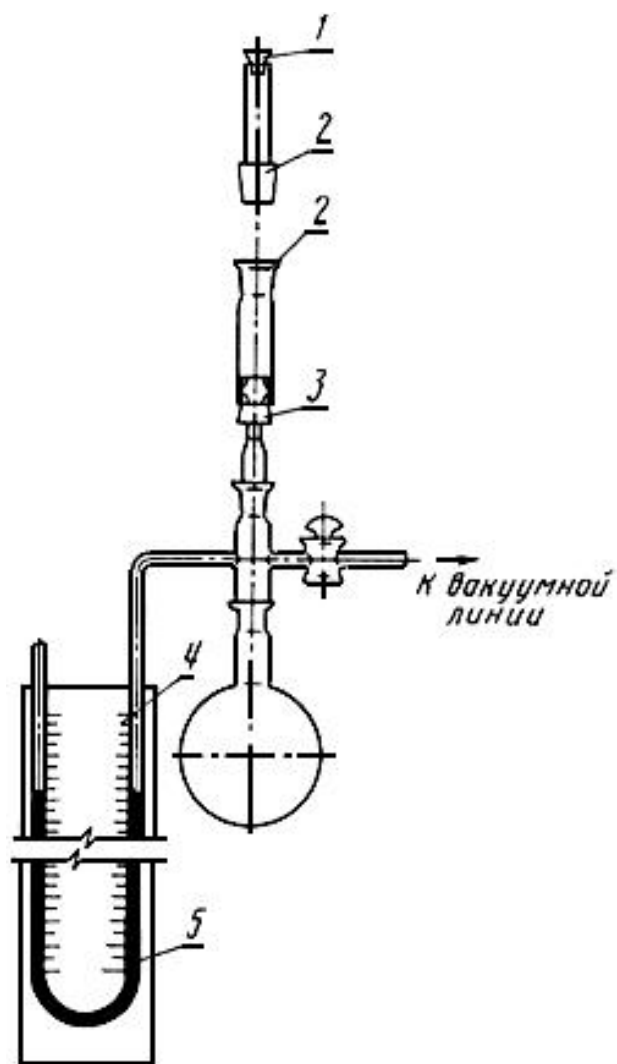

1 - резиновая пробка; 2 - испытуемый шлиф; 3 - резиновая пробка или трубка по размеру испытуемого соединения; 4 - шкала с диапазоном измерения давления приблизительно от 350 до 760 мм рт.ст. (45-100 кПа), с ценой деления 1 мм (0,133 кПа); 5 - ртутная U-образная манометрическая трубка

Рисунок 4

Важно, чтобы все соединения в испытательной установке не давали утечки, и сама установка была проверена перед присоединением к испытываемому соединению. Утечка, обнаруженная во время проверки, должна быть незначительной по сравнению с утечкой, наблюдаемой во время испытания.

Степень чистоты шлифованной поверхности - важный фактор, влияющий на скорость утечки. Составные элементы сначала протирают тканью, пропитанной соответствующим растворителем, например циклогексаном, затем опускают в этот растворитель и сушат. Частицы, прилипшие к поверхности, удаляют щеткой из верблюжьего волоса.

Затем составные элементы помещают по очереди в установку, в разреженную систему, в вертикальном положении.

На соединение влияет только атмосферное давление. При показании ртутного манометра выше 380 мм (50,54 кПа) запорный кран закрывают и через 1 мин снимают показания шкалы. Через 5 мин показания шкалы снимают повторно.

После уравнивания внутреннего и внешнего давлений составной элемент поворачивают по оси на 90° и затем испытание повторяют.

Примечание - При испытании кернов и муфт, отвечающих этим геометрическим требованиям при условиях, указанных выше, увеличение давления в системе в течение 5 мин не превышает 10 мм рт.ст. (1,33 кПа) при общей емкости 1,5 дм<sup>3</sup>. При общих емкостях, отличных от 1,5 дм<sup>3</sup>, соответствующее максимальное повышение давления обратно пропорционально емкости.

Текст документа сверен по:  
официальное издание

Посуда и оборудование лабораторные.

Технические условия. Методы испытаний: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003